# Bedienungsanleitung MWS 3Y & 485Y-Sensoren mit Mikroprozessor ohne Datalogger



# REINHARDT System- und Messelectronic GmbH

Bergstr. 33, D-86911 Dießen-Obermühlhausen Tel. 0049 - 8196 - 934100 or 7001

E-Mail: wetter@reinhardt-testsystem.de www.reinhardt-wetterstationen.de

# Inhaltsverzeichnis

1 Zur Beachtung	5
1.1 Verwendung	
1.1.1 Lagerung	
1.2 Sicherheitshinweise	5
1.3 Montage	6
2 Inbetriebnahme	6
2.1 Hardware Installation	6
2.2 Installation der Software	7
2.3 Start der Software	7
3 Technische Details	7
3.1 Wartung und Pflege	7
3.2 Die Sensorik	8
3.2.1 Der Temperatursensor (MWS 3Y, DFT 485Y, FTS 485Y und DTS 485Y)	8
3.2.2 Der Feuchtesensor (MWS 3Y, DFT 485Y und FTS 485Y)	
3.2.3 Der Drucksensor (MWS 3Y, DFT 485Y und DTS 485Y)	
3.2.4 Der Windgeschwindigkeitssensor (MWS 3Y, WGS 485Y, WGWR 485Y)	
3.2.5 Der Windrichtungssensor (MWS 3Y, WRS 485Y, WGWR 485Y)	
3.2.6 Der Helligkeitssensor HKS 485Y	
3.2.7 Der Bewölkungssensor WKS 485Y	
3.2.8 Der Global-Strahlungssensor GSS-485Y	
3.2.9 Der UV-Strahlungssensor UVS-485Y	
3.2.10 Der UVI-Strahlungssensor UVIS-485Y	
3.2.11 Der RegenDetektorRadar RDR-485Y	
3.3 Genauigkeit Sensoren	
3.3.1 Messbereiche	
3.4 Spannungsversorgung	
3.4.2 Leistungsaufnahme	
3.5 Datenformat	
3.5.1 RS232 / RS422 Schnittstelle	
3.5.2 RS485 Schnittstelle	
3.6 System Voraussetzungen	
3.6.1 System Voraussetzungen (32-bit Versionen)	
4 Anschlußmöglichkeiten und Steckerbelegungen	17

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y\_d.pmd Seite 2

4.1 Anschlußkabel	
4.1.1 Datenkabel - Belegung des Anschlusskabels für MWS 3Y	
4.1.2 Belegung des Anschlusskabels für den Sensor mit RS422-Schnittstelle	18
5 Auszug aus den Richtlinien für automatische Klimastationen des DWD	19
6 Trouble Shooting	20
6.1 Fehlerprotokoll-Datei (16-bit Versionen)	20
6.2 Protokoll-Dateien (32-bit Versionen)	20
6.2.1 Logfile im Fehlerfall (ErrLog.txt)	
6.2.2 Logfile beim Start (log.dat)	20
7 Optionen	21
7.1 Lieferbare Anzeigegeräte	21
7.1.1 Meteograf	21
7.1.2 DKA1	21
7.1.3 DMMK	21
8 Technischer Anhang	22
8.1 Steuerung des Mikroprozessors	22
8.1.1 Eingabe-Parameter des MWS 3Y / 485Y-Sensoren Mikroprozessors	22
8.2.3 Reihenfolge der Sensoren der MWS 3Y	26
9 Ersatzstecker	27
9 1 Anschlussumsetzer Rinder - Yamaichi	28

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y\_d.p65 Seite 3



REINHARDT System- und Messelectronic GmbH email: wetter@reinhardt-testsystem.de Web: www.reinhardt-wetterstationen.de

### 1 Zur Beachtung

### 1.1 Verwendung

Die Reinhardt-Wetterstation MWS 3Y und die 485Y-Sensoren (im weiteren Handbuch immer als MWS 3Y bezeichnet) sind zum stationären Betrieb zur Kurzzeit-Erfassung von Klimaparametern im Freien bei Temperaturen von -40°C...+60°C bestimmt. Ein Betrieb auf Fahrzeugen oder Maschinen ist nicht angezeigt! Für Langzeitmessungen über das ganze Jahr hat die Firma Reinhardt optional beheizbare Wetterstationen und Sensoren mit Datenlogger im Sortiment, wie z.B. MWS 55VY, MWS 10, Sensoren mit Logger (DFT 55VY, WDS 55VY, usw).

Eine andere Verwendung als die oben beschriebene kann zur Beschädigung des Produkts führen, außerdem bestehen andere Gefahren.

Montieren Sie die Wetterstation nicht in Reichweite von Haustieren und Kindern.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig aufmerksam durch, sie enthält viele wichtige Informationen für Aufstellung, Betrieb und Bedienung.

### 1.1.1 Lagerung



ACHTUNG: Wird die MWS 3Y nicht sofort in Betrieb genommen, muss diese an einem gut belüfteten Platz gelagert werden! Keinesfalls sollte die MWS 3Y in einer Verpackung über einen längeren Zeitraum gelagert werden, da praktisch alle Verpackungsmaterialien Lösungsmittel ausgasen, was zur Drift des Feuchtesensors führt und die Feuchtemessung nach einigen Wochen Lagerung nicht mehr innerhalb der Spezifikationen liegt!!

Siehe: <u>Sensirion Humidity Sensors Handling Instructions.pdf</u> oder hier: https://sensirion.com/resource/user\_guide/sht/handling\_instructions

### 1.2 Sicherheitshinweise



Die Geräte entsprechen dem modernsten technischen Standard und sind bei bestimmungsgemäßem Betrieb gefahrlos zu betreiben.



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.



Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.



Sehr geehrter Kunde, die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit, sondern auch zum Schutz des Gerätes. Lesen Sie bitte die folgenden Punkte aufmerksam durch:



Die Versorgungsspannung wird durch schutzisolierte Netzteile in berührungssichere Spannungen bis maximal 24VDC (die MWS 3Y und 485Y-Sensoren vertragen bis zu 30VDC) umgewandelt. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile, falls Sie ein konfektionieres Kabel erworben haben.



An den Wetterstationen befinden sich spitze und scharfkantige Teile, die bei unvorsichtiger Handhabung zu Verletzungen führen können. (Windfahne und Gehäusekanten).



Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Diese Teile könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Gehen Sie vorsichtig mit diesem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y d.pmd Seite 5

REINHARDT System- und Messelectronic GmbH

Bergstr. 33. D-86911 Dießen-Obermühlhausen. Tel. 0049 - 8196 - 934100 oder 700<sup>.</sup>

### 1.3 Montage

Zur Montage der Wetterstation wird eine Sensorhalterung (ein stabiles Blech mit einem 18mm Loch) benötigt. Diese Halterung kann als Winkelblech ausgeführt sein (wird dann an ein Rohr angeflanscht) oder als Ausleger eines Mastes.

Der Gewindeschaft (M18, Länge 8mm) der MWS 3Y wird in das Loch gesteckt, die Station nach Norden ausgerichtet und mit der beiliegenden Mutter fest fixiert.



ACHTUNG: Zum Befestigen des Sensors fassen Sie ihn auf keinen Fall oben an, sondern ausschließlich unten am Schaft, da andernfalls die Platine im Inneren verdreht und zerstört werden kann!!

Zuletzt wird das Anschlußkabel montiert sowie die Spannungsversorgung angeschlossen. Die MWS 3Y ist nun betriebsbereit und sendet jede Sekunde einen Datenstring (nur RS232/RS422).

 $\label{lem:mass} \begin{tabular}{ll} Die MWS~3Y~und~die~485Y~Sensoren~beinhalten~Sensoren~zur~Messung~der~wichtigsten~Klimaparameter~wie~Temperatur,~Luftfeuchte,~Luftdruck,~Windrichtung~und~Windgeschwindigkeit. \end{tabular}$ 

Alle Parameter können über die <u>(optionale) Software</u> grafisch, als Digitalanzeige oder in einer Multianzeige dargestellt werden.

Außerdem stehen eine Statistik, eine Prozesssteuerung und eine Historie-Funktion zur Verfügung.

### 2 Inbetriebnahme

### 2.1 Hardware Installation

Befestigen Sie die Wetterstation wie oben beschrieben.

Achten Sie darauf, die MWS 3Y möglichst senkrecht montiert wird, sonst kann die Windfahne nicht korrekt arbeiten und dreht sich bevorzugt immer in eine Richtung.

Montieren Sie die Wetterstation nicht an einem windgeschützten Standort, da sonst die Windparameter nicht korrekt gemessen werden können.

(Siehe auch "Auszug aus den Richtlinien für automatische Klimastationen lt. DWD")

Wenn Sie kein Kabel mitbestellt haben, erstellen Sie sich mit den beigefügten Steckern ein Kabel nach Ihren Wünschen. Zur Spannungsversorgung benötigen Sie ein Netzteil (12-24VDC). Schließen Sie dann das Kabel wie folgt an:

Den 9-poligen D-SUB Stecker verbinden Sie mit einer freien seriellen Schnittstelle des PC. Das Netzteil stecken Sie in eine Steckdose 230V / 50Hz (100V..240V / 50-60Hz) oder schließen Sie das System an ein Solarpanel (12V oder 24V) mit Akku an.



### Sicherheitshinweis

Es dürfen nur Netzteile mit einer Ausgangsspannung zwischen 6V und 30V Gleichspannung verwendet werden. Alle von uns gelieferten Netzteile sind ausschließlich für den Betrieb in trockenen Räumen ausgelegt! Die MWS 3Y benötigt an +12VDC ca. 10mA, an +18VDC ca. 6mA Strom, die 485Y-Sensoren je nach Ausstattung von 800µA bis 10mA).

Die MWS 3Y beinhaltet keinen Verpolungsschutz, beachten Sie also unbedingt die polrichte Anschaltung der Versorgungsspannung!

Lösen Sie auf keinen Fall die 6 seitlichen Inbusschrauben! Diese halten die Gehäuseteile zusammen. Bei Nichtbeachtung kann die MWS 3Y Schaden nehmen!

Nach der Installation der Hardware wird nun die Software installiert und gestartet.

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y d.p65 Seite 6

REINHARDT System- und Messelectronic GmbH

### 2.2 Installation der Software

Stecken Sie den mitgelieferten Wetter-Stick (USB) in einen USB-Port.

Bitte beachten Sie, dass bei einigen Sensoren die Software nur als Option erhältlich ist.

Sie benötigen einen HTML-fähigen Browser (Firefox, Edge oder andere).

Führen Sie STARTER.EXE im Stammverzeichnis des WetterSticks aus. (Wenn Sie die Softwarepakete direkt installieren möchten, finden Sie in der Datei install.html die Pfade zu den einzelnen Installationen.)

Folgen Sie dann den Hinweisen auf dem WetterStick.

### 2.3 Start der Software

Starten Sie die Software durch Doppelklick auf das Programmsymbol

Zuerst wählen Sie den Pfad, auf dem die Wetterdaten gespeichert werden sollen. Optional können Sie einen 2. Pfad zu Datenspeicherung wählen. Dann tragen Sie Ihr gewünschtes Speicher Intervall ein.

Wählen Sie dann unter *Datenspeicherung konfigurieren* die Option *Ohne Datenspeicher*. Übernehmen Sie die Einstellungen.

Ein neues Dialogfenster erscheint.

Wählen Sie jetzt die Schnittstelle aus (COM1, COM2, etc).

Startet die Software nicht, so könnte sich ein fehlerhaftes Datenfile auf der Festplatte befinden oder zu wenig freier Speicher zur Verfügung stehen. Das führt zu einem Abbruch.

(Näheres zu den Bestandteilen der Software finden Sie in den Handbüchern zur Software). Das Handbuch zur aktuellen Wettersoftware finden Sie hier.

Falls Sie eine eigene Auswertesoftware erstellen, können Sie direkt auf den Datenstring zugreifen. Die Schnittstelle lässt sich stumm schalten, so dass Sie Daten nur bei Bedarf abholen können. Dies ist bei RS485 Schnittstellen immer der Fall.

(Näheres dazu im Technischen Anhang unter Steuerungsparameter)

### 3 Technische Details

Da die MWS 3Y keinen Datenlogger besitzt, muss die Software für eine lückenlose Aufzeichnung permanent laufen.

### 3.1 Wartung und Pflege

Die MWS 3Y ist durch die ausgeklügelte Sensorik nahezu wartungsfrei.



Garantieansprüche erlöschen bei jeglichem Eingriff in die Hard- oder Software!

Die MWS 3Y Wetterstation wurde für den stationären Gebrauch für Kurzzeitmessungen unter normalen klimatischen Bedingungen (gemäßigtes Klima) konzipiert. Eine Benutzung unter extremen Bedingungen, wie z.B. auf Schiffen, etc., ist nicht angezeigt.

Ebenso ist es nicht ratsam, die MWS 3Y an Standorten aufzustellen, an denen die Wetterstation Salzwasser etc. ausgesetzt ist (z.B. direkt an der Küste, etc.).

Mobiler Betrieb auf einem Messfahrzeug ist unter gewissen Bedingungen möglich, wenn man von der Reproduzierbarkeit der Messwerte der Windsensoren absieht. Starke Erschütterungen bei Betrieb auf Fahrzeugen im Gelände sind auf jeden Fall zu vermeiden, da diese zur Beschädigung der Sensorik führen können!

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y\_d.pmd Seite 7

REINHARDT System- und Messelectronic GmbH

Bergstr. 33. D-86911 Dießen-Obermühlhausen. Tel. 0049 - 8196 - 934100 oder 700<sup>.</sup>

### 3.2 Die Sensorik

### 3.2.1 Der Temperatursensor (MWS 3Y, DFT 485Y, FTS 485Y und DTS 485Y)

Die Temperaturmessung basiert auf einem voll kalibrierten Sensorelement mit I²C Interface. Der resultierende Messwert wird durch den Mikrokontroller ausgewertet und an der Schnittstelle mit der Kennung TE ausgegeben. Der Temperatursensor ist geschützt im Inneren des Gehäuses eingebaut.

Bereich: von -40 °C bis + 60 °C, Messgenauigkeit ± 1,0 °C, (Anzeige über die Wettersoftware auch in °Fahrenheit oder Kelvin)

ACHTUNG: Die Messwerte können bei Sonnenschein im Vergleich zu Messungen in Wetterhütten deutlich höher ausfallen. Soll die Temperaturmessung mit Messungen in Wetterhütten korrelieren, ist die Messung an einer abgeschatteten Messstelle vorzunehmen! Einheit [°C]

### 3.2.2 Der Feuchtesensor (MWS 3Y, DFT 485Y und FTS 485Y)

basiert auf einem voll kalibrierten Sensorelement mit I<sup>2</sup>C Interface.

Der resultierende Messwert wird durch den Mikrokontroller ausgewertet und an der Schnittstelle mit der Kennung FE ausgegeben. Der Feuchtesensor ist geschützt im Inneren des Gehäuses eingebaut.

Der Feuchtesensor ist in einem Temperaturbereich von von -40 °C bis + 60 °C einsetzbar und auf eine Genauigkeit von 2.5 % linearisiert (zwischen 10 und 90% relativer Feuchte bei 25°C). Der Feuchtesensor ist voll betaubar.

Bereich: von 10 bis 100 %, Messgenauigkeit  $\pm 2.5$  % bei 25°C (zwischen 10 und 90%Feuchte), von 0°C...50°C +/- 3%. Anzeige auch als Taupunktmessung in °C oder °F. Einheit [%]

### Achtung

Dieser Sensor ist empfindlich gegenüber statischer Aufladung und Luftverschmutzung (Staub, aggressive Gase, aber auch Salz, etc).

Beachten Sie, dass dieser Sensor bei ungünstigen Bedingungen (häufige Betauung, mikrobiologischer Belastung durch Schimmelsporen, Bakterien, etc.) eine schnellere Alterung aufweist als unter Normalbedingungen.

### 3.2.3 Der Drucksensor (MWS 3Y, DFT 485Y und DTS 485Y)

besteht aus einem 16-bit Druckmodul mit integriertem Temperatursensor zur Kompensation. Auch dieser Sensor hat ein I<sup>2</sup>C Interface und gibt den Wert für den Druck mit der Kennung DR aus. Der Temperatursensor des Drucksensors hat die Kennung TD.

# Der Sensor TD wird für die Ermittlung des korrekten Luftdrucks zwingend benötigt und darf deshalb nicht deaktiviert werden!

Sie können den Drucksensor in einem Temperaturbereich von -40 °C bis + 60 °C einsetzen. Anzeigebereich: von 300 hPa bis 1100 hPa mit ± 1.0 hPa typischer Messgenauigkeit.

Anzeige wahlweise reduziert auf 0m Meereshöhe, Ortshöheneingabe in m, Anzeige auch in mm Quecksilbersäule oder Inch Quecksilbersäule.

Eine mögliche Formel zur Reduktion auf Meereshöhe lautet:

 $Barometer = Absolutdruck \; [hPa] + ((Ortsh\"{o}he \; [m] \; + 199,1) / \; 10,079) - ((Ortsh\"{o}he \; [m] - 2000) / \; 450)^{2}$ 

Dies ist eine einfache Formal zur Druckreduktion. Es gibt weitere Formeln, die Sie auf einschlägigen Seiten im Internet finden. Diese lassen sich bei Bedarf in der Reinhardt Wettersoftware einfügen, um den Druck anderweitig auf Meereshöhe zu reduzieren. Einheit [hPa]

Der Drucksensor ist luftverfrachtbar.

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y d.p65 Seite 8

REINHARDT System- und Messelectronic GmbH

email: wetter@reinhardt-testsystem.de Web: www.reinhardt-wetterstationen.de

### 3.2.4 Der Windgeschwindigkeitssensor (MWS 3Y, WGS 485Y, WGWR 485Y)

ist ein Dreischalenanemometer mit optischer Abtastung. Die Windgeschwindigkeit wird berührungslos über einen optischen Detektor gemessen. Ein Spitzenwertdetektor erfasst jede Windspitze und stellt sie dann an der Schnittstelle zur Verfügung (Kennung WS). Die Windgeschwindigkeit hat die Kennung WG. Ebenso wird ein Mittelwert innerhalb der jeweiligen Speicherintervalle gebildet und nach Speicherung auf die Festplatte zurückgesetzt (Kennung WD).

Bereich: in km/h von 0 bis 200 km/h mit ± 2.5 km/h Messgenauigkeit, (Anzeige auch in m/s, miles/h, Knoten oder Beaufort), Anlaufgeschwindigkeit < 0.8 m/s.

Durch die komfortable 3-fache Windgeschwindigkeitserfassung mit momentaner Windgeschwindigkeit (WG), Winddurchschnitt (WD) und Windspitzenerfassung (WS) können Sie die Windmessung ganz Ihren speziellen Bedürfnissen anpassen.

Beachten Sie jedoch, dass die 3 verschiedenen Messmethoden zur Windgeschwindigkeitsermittlung je nach den momentan herrschenden Windverhältnissen stark abweichende Messwertkurven erzeugen können, da bei der Messung WG nur ein momentaner Wert im gewählten Messintervall geschrieben wird, bei WD und WS jedoch kontinuierlich ausgewertet und wirklich der ganze Messzeitraum überwacht wird.

Einheit [km/h]

### 3.2.5 Der Windrichtungssensor (MWS 3Y, WRS 485Y, WGWR 485Y)


besteht aus einer miniaturisierten Windfahne und einem magnetischen Präzisions-Winkelencoder mit einem Drehwinkel von 360 ° zur Auflösung der Windrichtungsposition. Die Windrichtung wird in ° angegeben, wobei 90° für Osten steht, 180° für Süden, 270° für Westen und 0° für Norden. Bereich: in 360°, Messgenauigkeit 5°, Anlaufgeschwindigkeit < 0.8 m/s, Hysterese max 5°. Die Ausgabe erfolgt mit der Kennung WR. Einheit  $|\circ|$ 


### 3.2.6 Der Helligkeitssensor HKS 485Y

Der Helligkeitssensor (TSL4531) beinhaltet ein Photodioden Array, einen integrierten ADC, eine komplette Signal-Aufbereitung mit integrierter Lux-Berechnungs Logik und ein I<sup>2</sup>C Interface. Er misst die Lichtstäke in Lux im sichbaren Bereich (Human Eye Response).

Der Messbereich erstreckt sich von 0..220.000 lux, die Ausgabe erfolgt in lux mit der Kennung LX. Die Messgenauigkeit liegt bei +/- 10% vom Messwert.

Den Spektralbereich und die Winkelabhängigkeit ersehen Sie aus folgenden Diagrammen.





geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y\_d.pmd Seite 9

REINHARDT System- und Messelectronic GmbH

Bergstr 33 D-86911 Dießen-Obermühlbausen, Tel 0049 - 8196 - 934100 oder 700

### 3.2.7 Der Bewölkungssensor WKS 485Y

Der Bewölkungssensor detektiert das Vorhandensein von Bewölkung mit Hilfe eines Thermosäulendetektors.

Bei Bewölkung gibt der Sensor an der Kennung WK den Wert 1 aus, detektiert der Sensor keine Bewölkung, wird der Wert von WK mit 0 ausgegeben.

Zusätzlich dazu wird noch ein Messsignal ausgewertet, über welches die Wolkenhöhe über die sogenannte Höhenformel bestimmt wird.

Die Höhenformel lautet wie folgt:  $T(h) = T_0 - h * y$ , wobei T(h) die Temperatur der Wolke,  $T_0$  die Temperatur des Sensors selbst, h die Höhe und y der Temperaturgradient in [K/m] sind.

Der Temperaturgradient y gibt an, um wieviel Kelvin sich die Luft bei einem Meter Höhengewinn abkühlt. Die Größe dieses Gradienten hängt davon ab, ob die Luftmasse trocken oder feucht ist (trockenadiabatischer oder feuchtadiabatischer Temperaturgradient).


Der feuchtadiabatische Temperaturgradient hat einen Wert von ca. 5\*10<sup>-3</sup> Km<sup>-1</sup>, der trockenadiabatische Temperaturgradient hat einen Wert von ca. 10<sup>-2</sup> Km<sup>-1</sup>.

Da die genauen Wetterumstände meist nicht bekannt sind, rechnen Meteorologen im Allgemeinen mit einem Durchschnittswert von  $6.5*10^{-3}$  Km<sup>-1</sup>, also mit einer Abkühlung von ca. 6.5°C pro Kilometer. Dieser Wert wird auch beim WKS 485Y zu Grunde gelegt.

Der Sensor mit der Kennung WU gibt dann die ermittelte Wolkenuntergrenze in Metern aus.

Die dadurch ermittelte Wolkenuntergrenze unterliegt vielen Unsicherheiten und darf nicht für sicherheitsrelevante Messungen (z.B. Flugbetrieb, usw.) verwendet werden!

Rechts ist das Sichtfeld des verwendeten Thermsäulendetektors abgebildet. Wir verwenden den TPD 1T 0514, bzw. den TPD 1T 0214

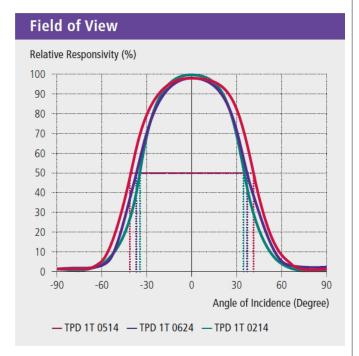

### 3.2.8 Der Global-Strahlungssensor GSS-485Y

ist ein Pyranometer, das die Strahlung zwischen 305 und 2800 nm aufnimmt. Die Temperaturdifferenz zwischen einem geschwärzten und einem reflektierenden Element wird ermittelt und von der Software linearisiert. Der Messsensor ist ein Thermoelement.

Die Werte werden in W/m² ausgegeben.

Im Datenstring werden zwei Kennungen ausgegeben:

SO ist die Globalstrahlung in W/m<sup>2</sup>,

SI ist ebenso die Globalstrahlung in W/m², allerdings stark bedämpft und mit geringerer Auflösung. Der Messwert erreicht nach ca. 60 Sekunden 90% seines Endwertes.

Einheit [W/m<sup>2</sup>]

Bereich: von 0 bis 1500 W/m² mit einer Genauigkeit von ±40 W/m² bei 25°C.

geändert am 25.09.2025 von DO


MWS3Y d.p65 Seite 10

email: wetter@reinhardt-testsystem.de Web: www.reinhardt-wetterstationen.de

### 3.2.9 Der UV-Strahlungssensor UVS-485Y

misst die UV-Strahlung (UV-A) in mW/m². Der Spektralbereich beträgt 320nm..395nm mit maximaler Empfindlichkeit bei 330nm.


Die relative spektrale Empfindlichkeit des Sensors ersehen Sie aus dem folgenden Diagramm. Es gilt die Kurve für die JEC 0.1A!

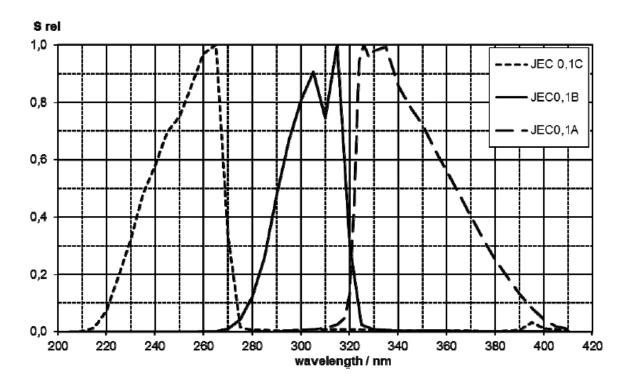

### 3.2.10 Der UVI-Strahlungssensor UVIS-485Y

misst direkt den UV-Index (Erythem Wirkungsspektrum) im sonnenbrandwirksamen Spektralbereich. Die maximale Empfindlichkeit liegt bei 297nm.

Die relative spektrale Empfindlichkeit des Sensors ersehen Sie aus dem folgenden Diagramm.

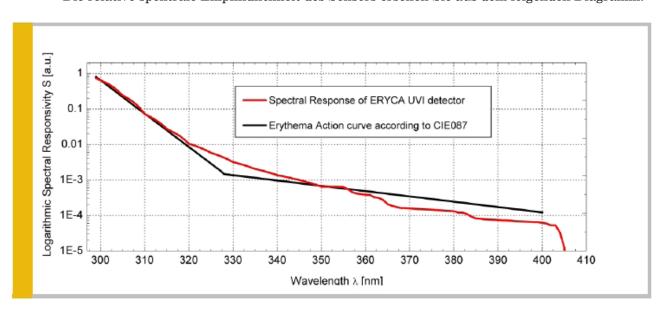

geändert am 25.09.2025 von DO MWS3Y\_d.pmd Seite 11

REINHARDT System- und Messelectronic GmbH

### 3.2.11 Der RegenDetektorRadar RDR-485Y

ist ein wartungsfreier Regendetektor mit einem 24GHz Doppler-Radar zur Erfassung der Aktivität von Regen und Hagel.

Um Messungsausfälle zu vermeiden darf der Sensor nach oben hin nicht abgeschattet sein. Achtung: feiner Nieselregen und Schneefall können nicht sicher detektiert werden. Dies hängt mit zu geringem Wasseranteil, Tropfengröße und Fallgeschwindigkeit zusammen die keine ausreichende Reflexion der Radarwellen erreichen und somit nicht erfasst werden können.

Der Radar-Regensensor detektiert auftreffende oder vorbeifallende Tropfen. Hierbei kann allerdings nicht zwischen tatsächlichen Regentropfen oder anderen Objekten unterschieden werden. Deshalb muss der Sensor so Montiert werden das er genügend Abstand zu sich bewegenden Objekten hat, z.B.: Laubfall bzw. "Trümmerschatten" von Bäumen oder Dächern, Insektenschwärmen, Passanten, Straßen- und Schienenverkehr usw.

Desweiteren darf der Sensor nicht in der Nähe von Neonröhren, Gasentladungslampen und anderen Systemen mit 24GHz Radarsensoren betrieben werden.

Um eine fehlerhafte Detektion bei nur einem kurzzeitigem Ereignis (Störimpuls, Insekten bzw. Vogelflug, & vom Wind getragene Fremdkörper) zu vermeiden, erfolgt eine Sperrung nach der Ersterfassung von ca. 1,5Sec. Danach ist die Sensorerfassung für ca. 1Min. freigeschaltet und setzt den Sensor RA auf "Hi" wenn während dieser festgelegten Frist eine erneute Erfassung erfolgt. Der Sensor RA wird bei erfolgter Detektion ca. 2Min. auf "Hi" gesetzt. Wenn während dieser Zeit erneut detektiert wird beginnt die Zeitmessung von neuem (Retrigger).

### 3.2.12 Empfindlichkeitseinstellung des RDR-485Y

Der RDR-485Y führt einen 2. Sensor mit der Kennung RS im Ausgabestring, welcher die Intensität bei Detektion repräsentiert. Dieser Wert wird in mV ausgegeben.

Die Empfindlichkeitseinstellung der Detektions-Schwelle kann mit dem Befehl !X0 = Unempfindlicher (reagiert bei ca. 120mV) und !X1 = Empfindlich (reagiert bei ca. 70mV) ausgewählt werden. Bei Sachgemäßer Anbringung (nicht in der Nähe von Störungsquellen) sollte immer die Einstellung "Empfindlich" gewählt werden damit der Sensor auch bei feinen Tropfen gut detektieren kann. Die Einstellung bei Auslieferung ist "Empfindlich".

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y d.p65 Seite 12

### 3.3 Genauigkeit Sensoren

Temperatur:  $\pm 0.5$  °C (bei +25°C)

 $\pm$  1,0 °C (zwischen -10°C und +60°C)

Feuchte: ± 2.5 % (zwischen 10 und 90% Feuchte, bei 25°C)

± 4.0 % (zwischen 10 und 90% Feuchte, bei 0..50°C) ± 5.0 % (zwischen 10 und 90% Feuchte, bei -30..0°C)

Druck: ±1.0 hPa (typisch, zwischen 300hPa und 1100 hPa bei 0°C..50°C),

±2.5 hPa (max., zwischen 700hPa und 1100 hPa bei 0°C..50°C), ±3.0 hPa (max., zwischen 300hPa und 700 hPa bei 0°C..50°C), ±4.0 hPa (max., zwischen 300hPa und 1100 hPa bei -20°C..0°C)

Temperatur Drucksensor: ± 2.0 °C (zwischen -10°C und +60°C) Windrichtung: ± 5° (bei 5°C..50°C), Hysterese < 5°

Anlaufgeschwindigkeit: < 0.8m/s (bei 5°C..50°C)

 $\label{eq:windgeschwindigkeit:} \begin{array}{ll} \text{Windgeschwindigkeit:} & \pm 2.5 \text{ km/h (bei } 5^{\circ}\text{C}..50^{\circ}\text{C}) \\ \text{Anlaufgeschwindigkeit:} & < 0.8 \text{ m/s (bei } 5^{\circ}\text{C}..50^{\circ}\text{C}) \end{array}$ 

Helligkeit: +/- 10%

maximale Drift von -0.25% / °C bei -15°C..0°C maximale Drift von -0.20% / °C bei 0°C..70°C

Globalstrahlung +/- 40 W/m<sup>2</sup>

UV-A +/-10%

UVI +/- 1/2 UV-Index

### 3.3.1 Messbereiche

Temperatur: von -40 ° bis + 60 °, Auflösung 0,01 °C (16 bit) relative Feuchte: von 10 bis 100 % Auflösung 0,01 % (16 bit) von -40 ° bis + 60 °, Auflösung 0,01 °C von -40 ° bis + 60 °, Auflösung 0,01 °C

absoluter Druck: von 300 hPa bis 1100hPa in 0.01 hPa Auflösung (16 bit)

Windrichtung: 0 bis 360°, Auflösung 0.3° (10bit)

Windgeschwindigkeit: in km/h von 0 bis 200 km/h mit 0,05 km/h Auflösung Helligkeit: in lux von 0 bis 220000 lux mit 4 lux Auflösung

 $\begin{array}{ccc} \text{UV-A} & 0 \text{ bis } 50000 \text{ mW/m}^2 \\ \text{Globalstrahlung} & 0 \text{ bis } 1500 \text{ W/m}^2 \end{array}$ 

Maße MWS 3Y:

Größe: Außendurchmesser 110 mm bei einer Höhe von 180 mm

Gewicht: ca. 350 g

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y d.pmd Seite 13

### 3.4 Spannungsversorgung

6-30 VDC, 8-30V (RDR-485Y)

### 3.4.1 Stromverbrauch

Der typische Stromverbrauch mit RS-232 an verschiedenen Spannungen ist wie folgt:

Spannung:	6V	12V	18V	24V
NAMES OF	10. 4	0.77	20 4	<b>7</b> 0 4
MWS 3Y:	$19 \mathrm{mA}$	9.7 mA	6.8mA	$5.2 \mathrm{mA}$
DFT 485Y:	2.4mA	1.3mA	0.9 mA	0.7 mA
WGS 485Y:	7.0 mA	3.9mA	3.2mA	2.8mA
WKS 485Y:	3.2 mA	1.6mA	1.1mA	0.9 mA
GSS 485Y :	5.7 mA	2.8mA	1.9 mA	1.5mA
HKS 485Y :	4.5 mA	2.3mA	1.6mA	1.2 mA
UVIS 485Y:	5.6 mA	2.9 mA	2.0mA	1.6mA
RDR 485Y:	38mA (8V)	25mA	18mA	15mA

### 3.4.2 Leistungsaufnahme

Die typische Leistungsaufnahme mit RS-232 an 18VDC ist wie folgt:

MWS 3Y	: 6.8mA, Leistungaufnahme: 122mW
DFT 485Y	: 800µA, Leistungaufnahme: 16mW
WGS 485Y	: 3.2mA, Leistungaufnahme: 58mW
WKS 485Y	: 1.1mA, Leistungaufnahme: 20mW
GSS 485Y	; 1.9mA, Leistungaufnahme: 34mW
HKS 485Y	; 1.6mA, Leistungaufnahme: 29mW
UVIS 485Y	; 2.0mA, Leistungaufnahme: 36mW
RDR 485Y	; 18mA, Leistungaufnahme: 324mW

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y\_d.p65 Seite 14

### 3.5 Datenformat

### 3.5.1 RS232 / RS422 Schnittstelle

Das Datenformat der gesendeten Daten der MWS 3Y sieht folgendermaßen aus.

Beispiel eines Datensatzes:

TD22.13, TE22.09, DR952.25, WG2.00, WR78.91, FE35.58, WS4.11, WD3.29

Jede Sekunde sendet die MWS 3Y einen Datensatz, der durch Komma getrennt, die einzelnen Messwerte mit Sensorkennung standardmäßig in folgender Reihenfolge enthält:

Temperatur des Drucksensors (TD), Temperatur (TE), Barometer (DR),

Windgeschwindigkeit (WG), Windrichtung (WR), Feuchte (FE), Windspitze (WS),

Winddurchschnitt (WD).

Der Datensatz endet mit <CR><LF>.

Das Datenformat der gesendeten Daten des DFT 485Y sieht folgendermaßen aus.

Beispiel eines Datensatzes:

TD22.13, TE22.09, DR952.25, FE35.58

Jede Sekunde sendet der Sensor einen Datensatz, der durch Komma getrennt, die einzelnen Messwerte mit Sensorkennung standardmäßig in folgender Reihenfolge enthält:

Temperatur des Drucksensors (TD), Temperatur (TE), Barometer (DR), Feuchte (FE).

Der Datensatz endet mit <CR><LF>.

Das Datenformat der gesendeten Daten des WGS 485Y sieht folgendermaßen aus.

Beispiel eines Datensatzes:

WG9.13, WS18.23, WD12.23,

Jede Sekunde sendet der Sensor einen Datensatz, der durch Komma getrennt, die einzelnen Messwerte mit Sensorkennung standardmäßig in folgender Reihenfolge enthält:

Aktuelle Windgeschwindigkeit (WG), Windspitze seit dem letzten Reset (WS), Winddurchschnitt seit dem letzten Reset (WD).

Der Datensatz endet mit <CR><LF>.

Das Datenformat der gesendeten Daten des WKS 485Y sieht folgendermaßen aus.

Beispiel eines Datensatzes:

WU1264.00, WK1.00,

Jede Sekunde sendet der Sensor einen Datensatz, der durch Komma getrennt, die einzelnen Messwerte mit Sensorkennung standardmäßig in folgender Reihenfolge enthält:

Errechnete Wolkenuntergrenze in [m] (WU), bewölkt = 1.00, unbewölkt = 0.00 (WK),

Ab einer errechneten Wolkenuntergrenze von ca. 4000m schaltet der Sensor auf "unbewölkt".

 $Diese\,Schwelle\,kann\,ge\"{a}ndert\,werden, indem\,man\,dem\,Sensor\,dies\,per\,Terminal programm\,mitteilt.$ 

Näheres dazu erfahren Sie auf Anfrage von uns.

Der Datensatz endet mit <CR><LF>.

Das Datenformat der gesendeten Daten des HKS 485Y sieht folgendermaßen aus.

Beispiel eines Datensatzes:

LX23824.00

Jede Sekunde sendet der Sensor einen Datensatz, der die Helligkeit in lux enthält:

Helligkeit in [lux](LX).

Der Datensatz endet mit <CR><LF>.

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y d.pmd Seite 15

Diese Reihenfolge kann geändert werden, in dem man die Ausgabepositionen (!Kxx) mit den internen Sensornummern neu belegt (Die Befehle dazu finden Sie im Anhang).

Die Daten werden standardmäßig mit 9600BAUD, 8bit, no parity und einem Stopbit übertragen. (Für die Auswertung mit eigener Software lassen sich verschiedene Ausgabemodi einstellen siehe Anhang)

Auf der Festplatte wird pro Monat ein Datenfile erzeugt, dessen Format dem der gesendeten Daten gleicht. Die Datenfiles haben die Endung .MWS.

Ein Beispiel: Das File vom Januar 2012 heißt 01\_2012.MWS bei den 32-bit-Versionen.

Bei fehlenden Daten (Meßwertlücken, durch Stromausfall, etc.) schreibt die Software zur Wahrung der Integrität der Zeitachse Datensätze mit dem Meßwert -99999. Die Software interpretiert diese Werte (-99999 sowie -99997) als Meßwertlücken, die in der Kurvenanzeige zu einer Unterbrechung (Lücke) im Graphen führen.



### **ACHTUNG!**

Bei RS422 ist das EEPROM aus Sicherheitsgründen gesperrt, um ein versehentliches Umschalten auf RS232, welches ein Öffnen des Sensors zur Folge hätte, zu vermeiden. Der Schreibschutz kann im SECURE-Modus wieder aufgehoben werden.

(Siehe Punkt 8.1.1 - Eingabe-Parameter des MWS 3Y / 485Y-Sensoren Mikroprozessors)

### 3.5.2 RS485 Schnittstelle

Das Datenformat der gesendeten Daten ist identisch mit dem der Sensoren mit RS232 / RS422 Schnittstelle

Allerdings ist der Sensor mit RS485 Schnittstelle standardmäßig hochohmig (Tristate) und sendet nur auf explizite adressierte Anfrage den aktuellen Datensatz.

Hat der Sensor z.B. die Adresse "10", lautet der Befehl zur Ausgabe des aktuellen Datensatzes: ?10U, gefolgt von Carriage Return und LineFeed (Drücken der Enter-Taste).

### Wichtig!!

Die Standard Reinhardt Software kann die Sensoren mit RS485 Schnittstelle nicht auslesen, der Kunde benötigt hier eine eigene Software Lösung!



### ACHTUNG!

Bei RS485 ist ebenfalls das EEPROM aus Sicherheitsgründen gesperrt, um ein versehentliches Umschalten auf RS232, welches eine Reparatur des Sensors zur Folge hätte, zu vermeiden.

Der Schreibschutz kann im SECURE-Modus wieder aufgehoben werden.

Seit Version 1.29 kann eine Wartezeit des Sensors auf Befehle eingegeben werden. Der Befehl lautet !SWx, wobei x eine Zeit von 1..255 Millisekunden ist.

(Siehe Punkt 8.1.1 - Eingabe-Parameter des MWS 3Y / 485Y-Sensoren Mikroprozessors)

### 3.6 System Voraussetzungen

### 3.6.1 System Voraussetzungen (32-bit Versionen)

Für die Software zum Auslesen der MWS 3Y / Sensoren mit RS232 / 422 Schnittstelle wird mindestens ein Computer mit Pentium1 / 200 Prozessor und 32MB RAM benötigt. WIN98 SE, WIN ME, WIN2k, WIN XP Vista oder WINDOWS 7.

Eine Online-Hilfe ist jederzeit mit der F1-Taste oder über die Menüleiste beim '?' verfügbar.

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y d.p65 Seite 16

REINHARDT System- und Messelectronic GmbH

### 4 Anschlußmöglichkeiten und Steckerbelegungen

### 4.1 Anschlußkabel

### 4.1.1 Datenkabel - Belegung des Anschlusskabels für MWS 3Y

```
7 poliger Stecker (MWS 3Y-Anschluss)
                                                    9-poliger Schnittstellen-Stecker
Pin
    1 \quad (GND) \leftarrow
                                                           Pin 5 (GND)
Pin
    2 (GND - benötigt für MWS 10)
Pin 3 (RXD-MWS 3Y) ←
                                                           Pin 3
                                                                  (TXD-PC)
Pin 4 (TXD-MWS 3Y)
                                                           Pin 2
                                                                  (RXD-PC)
Pin 5 (VCC 18VDC)
Pin 6 (R- bei RS422 /485)
Pin 7 (T- bei RS422 /485)
                                                    Pin
                                                           4 und 6 verbinden
                                                    Pin
                                                           7 und 8 verbinden
```

Das Datenkabel kann bei optimalen Bedingungen und geeignetem Kabel bis zu 50m verlängert werden (nicht im industriellen Umfeld!!).


Beachten Sie bei der Verlängerung des Datenkabels, dass auf der Rechnerseite unbedingt die Brücken im Stecker verdrahtet werden

(Pin 4 mit Pin6 und Pin7 mit Pin8 verbinden).

Beachten Sie bei der Verlängerung des Datenkabels, dass auf der Rechnerseite unbedingt die Brücken im Stecker verdrahtet werden

(Pin 4 mit Pin6 und Pin7 mit Pin8 verbinden).

# Datenkabel MWS Standard RS232 V3.0 Data Cable MWS Standard RS232 V3.0

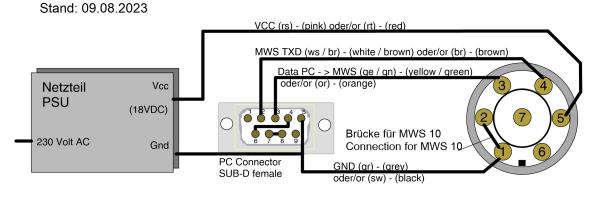

Kabellänge - cable length : max 100 m (in industriellem Umfeld max 15m) (in industrial environment max 15m) (Kabelstecker von vorn (Kontaktseite) (Connector front view (contact side view)

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y d.pmd Seite 17


### 4.1.2 Belegung des Anschlusskabels für den Sensor mit RS422-Schnittstelle

7 poliger Stecker (Sensor-Versorgung und Daten)

### Datenkabel RS422 - Datacable RS422 (MWS55 / MWS88 / MWS10 / Sens\_55

(Stand 09.08.2023)

(alle Ansichten auf die Frontseite - all views onto contact side)

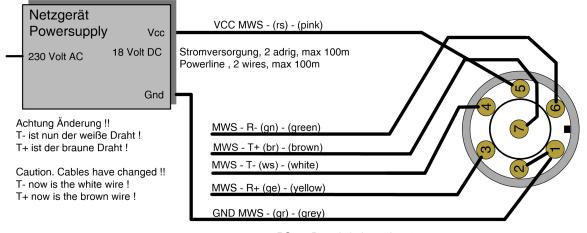

RS422 Datenkabel , 4 adrig, max 1000m RS422 Datacable , 4 wires, max 1000m

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y\_d.p65 Seite 18

### 5 Auszug aus den Richtlinien für automatische Klimastationen des DWD

### 2.2 Aufstellungsrichtlinien

### 2.2.1 Standortanforderungen

Wesentlich für die Auswahl des Standortes ist die repräsentative Lage für die betreffende Umgebung hinsichtlich Hindernis- und Horizontfreiheit sowie Beschaffenheit des Bodens und Bewuchses. Hindernisfreiheit wird insbesondere für die Windmessung benötigt. Horizontfreiheit ist die Voraussetzung für Messungen der Sonnenscheindauer.

In der Nähe von Sendeanlagen wie Richtfunk- oder Flugsicherungssendern sind zusätzliche Abschirmungsmaßnahmen notwendig.

• • •

Im näheren Umkreis von Rundfunk-Mittelwellensendern erweisen sich alle angewandten Schutzmaßnahmen als wirkungslos.

### 2.2.2 Messfeld

Das Messfeld soll eine Größe von ca. 10 x 10m haben, mindestens aber eine Größe von 6 x 6m...

### 3. Sensorik

### 3.1 Messung der Lufttemperatur 200cm

Standardmäßig wird die Lufttemperatur in 2m Höhe über Grund gemessen...

Die Messung der Lufttemperatur sollte möglichst in einer Klimahütte erfolgen, um den Strahlungsfehler gering zu halten...

### 3.4 Messung der relativen Luftfeuchte 200cm

Standardmäßig wird die Relative Luftfeuchte in 2m über Grund gemessen...

### 3.5 Messung der Niederschlagshöhe 100cm

...

Die Auffangfläche beträgt 200cm². Bei der Hornerschen Wippe erfolgt ein Wippenschlag bei einer Füllmenge von 2cm², die 0.1 mm Niederschlagshöhe entspricht.

### 3.7 Messung der Windgeschwindigkeit

Für die Messung der Windgeschwindigkeit wird ein Schalenstern-Anemometer verwendet, dessen Drehzahl der horizontalen Windgeschwindigkeit proportional ist...

### 3.8 Messung der Windrichtung

Zur Messung der Windrichtung wird eine Windfahne verwendet, die an einem Dreharm mit senkrechter Drehachse befestigt ist. Deren Ausrichtung im Wind wird durch den Druckunterschied zu beiden Seiten des Fahnenblattes bewirkt.

•••

Standardmäßig wird Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 10m über Grund gemessen.

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y d.pmd Seite 19

### 6 Trouble Shooting

Ist die Wetterstation ordnungsgemäß aufgestellt und die Software installiert, sollte die Datenaufzeichnung problemlos von statten gehen.

Sollten Sie Probleme bei der Datenübertragung haben, versuchen Sie, ob ein Herabsetzen der Baudrate auf 9600 oder 4800 Baud eine Verbesserung bewirkt. Bei Kabellängen über 15m sollten Sie kapazitätsarmes Kabel verwenden.

Ein Betrieb der Wetterstation im industriellen Umfeld kann wegen der Störeinstrahlung auf das Kabel große Probleme bei der Datenübertragung bewirken.

In diesem Fall sollten Sie abgeschirmte Leitungen oder noch besser eine RS422-Schnittstelle benutzen.

(Weitere Hinweise auch auf der WetterCD unter FAQs)

### 6.1 Fehlerprotokoll-Datei (16-bit Versionen)

Wichtig im Fehlerfall:

Die Versionen der Wettersoftware ab V1.06 erzeugen bei jedem Start der Software ein Protokoll-File des Datenverkehrs zwischen PC und Wetterstation. Bei DOS-Versionen heißt dieses File DIAGNOSE.LOG, bei WINDOWS-Versionen DIAG WS.LOG.

Diese Datei kann wertvolle Hilfe bei Problemen geben, sichern Sie also im Fehlerfall unbedingt dieses File, da dieses bei jedem Start der Software überschrieben wird.

Beachten Sie ebenfalls die Dateien mit der Endung .DOC. Darin finden Sie Wissenswertes zur Software der MWS 3Y, das noch nicht im Handbuch steht.

### 6.2 Protokoll-Dateien (32-bit Versionen)

### 6.2.1 Logfile im Fehlerfall (ErrLog.txt)

Bei den Softwareversionen für Sensoren ohne Logger wird ab der Version 2.26 im Fehlerfall (bei Datenfehlern oder Übertragungsproblemen) ein Log-File (**ErrLog.txt**) erstellt, in dem Zeitpunkt und Art des Problems gespeichert werden. In früheren Versionen konnte es vorkommen, daß eine Fehlermeldung (z.B. !P oder **Keine Daten von Wetterstation**) erschien, und permanet eingeblendet blieb, bis der Benutzer die Meldung bestätigt hat. Dies hatte jedoch zur Folge, daß unter Umständen keine weitere Speicherung der Daten auf die Festplatte erfolgt.

Nun erscheint eine Fehlermeldung, die aber wieder automatisch ausgeblendet wird, wenn der Fehler nicht mehr existiert. Es wird dann ein Eintrag ins Log-File eingefügt.

### 6.2.2 Logfile beim Start (log.dat)

Beim Start der Software für Sensoren mit Logger wird die Kommunikation zwischen Host (Computer) und Wetterstation in einem Log-File (**log.dat**) gespeichert. Daraus kann man im Problemfall eventuell wertvolle Hinweise ersehen.

**Achtung!** Dieses Log-File wird bei jedem Neustart der Software überschrieben. Speichern Sie also bei Problemen dieses File oder benennen Sie es um.

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y d.p65 Seite 20

email: wetter@reinhardt-testsystem.de Web: www.reinhardt-wetterstationen.de

### 7 Optionen

Weitere Zusatzmodule finden Sie hier:

http://www.reinhardt-testsystem.de/deutsch/klima\_sensoren/zusatzmodule.php

### 7.1 Lieferbare Anzeigegeräte

### 7.1.1 Meteograf

Präzisionsanzeige für Innenraumanwendungen mit 7 analogen Anzeigeinstrumenten, gesteuert durch hochwertige Schrittschaltmotoren.

### 7.1.2 DKA1

LED-Kleinanzeige zur abwechselnden Anzeige von bis zu 9 Messwerten, 13 mm Ziffernhöhe Nur für Innenanwendungen.

### 7.1.3 DMMK

Digital Meteoanzeige Multi klein, zur gleichzeitigen Anzeige von 10 Parametern über 13mm rote LED-7-Segmentanzeigen. Versionen für Wand- oder Standmontage verfügbar. Nur für Innenanwendungen.

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y\_d.pmd Seite 21

### 8 Technischer Anhang

Reset:

### 8.1 Steuerung des Mikroprozessors

### 8.1.1 Eingabe-Parameter des MWS 3Y / 485Y-Sensoren Mikroprozessors

### Eingabe-Flags zur Steuerung, !Fx, 0 <= x <= 255

8 : 9600

Bit 7 - nicht verfügbar

Bit 6 - Ausgabe der Geräteadresse (DA) mit <CR><LF> vor jedem Datensatz

Bit 5 - on: Reset des GE Eingangs mit !R, off: Reset des GE Eingangs mit !P

Bit 4 - nicht verfügbar

Bit 3 - nicht verfügbar

Bit 2 - nicht verfügbar

Bit 1 - nicht verfügbar

Bit 0 - nicht verfügbar

Wechseln von Messwert-Ausgabe und Abgleich-Modus (Ausgabe der Frequenz):

```
'!' 'W' <#13>
```

### Ein/Ausblenden einzelner Sensoren (Liste aller verfügbaren Sensoren weiter hinten)

```
'!' 'KX,A0' <#13> ; Sensor mit der Ausgabe-Nummer X wird nicht ausgegeben 
'!' 'KX,A1' <#13> ; Sensor mit der Ausgabe-Nummer X wird ausgegeben
```

### Sensordämpfung für Sensor ein / ausschalten

```
    '!' 'KX,M0' <#13> ; Sensor mit der Ausgabe-Nummer X wird nicht bedämpft
    !!' 'KX,M1' <#13> ; Sensor mit der Ausgabe-Nummer X wird bedämpft
```

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y d.p65 Seite 22

```
Übertragen von Linearisierungs-Daten:
'!' 'L' <SENSORNUMMER> ',' <INDEX : 1..5> ','
'F' < SPANNUNG(mV) > < #13 >
(gilt nur für ZA und ZB)
'!' 'L' <SENSORNUMMER> ',' <INDEX : 1..5> ','
'W' <ANALOGWERT> <#13>
(gilt nur für ZA und ZB)
'!' 'L' <SENSORNUMMER> ',' 'L' <Linearisierungsfaktor> <#13>
(Sensorabhängig)
"!" 'L' <SENSORNUMMER> ',' 'S' <Linearisierungssummand> <#13>
(Sensorabhängig)
'!' 'L' <SENSORNUMMER> ',' 'O' <Temperaturoffset> <#13>
(Sensorabhängig)
```

"!' 'L' <SENSORNUMMER> ',' 'T' <Temperaturkoeffizient> <#13> (Sensorabhängig)

Einstellen der Ortshöhe zur Anzeige des barometrischen Drucks '!' 'O'<ORTSHOHE(m)> <#13>

Rücksetzen der Windpeak und Winddurchschnittsberechnung "!" 'P' <#13>

### Toggle zwischen Ausgabemodus und Sicherheitsmodus '!"' <#13>



(SECURE-Mode: keine Messungen, keine Messwertausgaben, nur Ausgabe von \*\*SECURE\*\*) Im Sicherheitsmodus wird KEINE keine Adresse benötigt, auch wenn der Sensor sich im RS485 -Modus befindet!!

Im Secure-Modus kann der EEPROM-Schreibschutz wieder deaktiviert werden!

### Setzen einer Wartezeit nach Empfang eines Befehls '!' 'SWx'<#13>

wobei x eine Wartezeit von 1..255 Millisekunden ist. Default ist 5 ms.

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y d.pmd Seite 23



Ein / Ausschalten und Art der Schnittstelle (Protokoll-Select)

ACHTUNG: DIESE EINSTELLUNGEN SIND SEHR KRITISCH!!
Bei falscher Bedienung kann der Sensor irreparabel verstellt werden.
Eine fehlerhafte Änderung dieses Parameters, welche eine Reparatur nach sich zieht, ist von der Gewährleistung ausgeschlossen!!.

'!' 'SX' <#13> Unterdrückt u. a. die Ausgabe von Daten auf die Schnittstelle X ist der Dezimal-Wert aus der folgenden Binärliste für die verschiedenen Protokolle.

Binärliste der Protokoll-Parameter für X.

X (binär) =

xxxxxx00b : RS232 - MWS 3Y sendet jede sec einen Datensatz xxxxxx01b : RS422 - MWS 3Y sendet jede sec einen Datensatz xxxxxx10b : RS485 - MWS 3Y ist adressiert und sendet auf Anfrage

xxxxxx11b : not available

xxxxx1xxb : MWS 3Y sendet nur auf Anfrage (RS232 + RS422)

xxxx1xxxb : nicht verfügbar xxx0xxxxb : nicht verfügbar xxx1xxxxb : nicht verfügbar xx1xxxxxb : nicht verfügbar

1xxxxxxxb : EEPROM Schreibschutz

(Kann nur im SECURE-Modus wieder deaktiviert werden!)

Durch Kombination (Addition) einzelner Binärwerte können Sie die Parameter kombinieren. Beispiel für MWS 3Y mit RS422 sendet nur auf Anfrage :

X für RS422 (binär) = xxxxxx01 X für Senden auf Anfrage (binär) = xxxxx1xx addiert --> = xxxxx101 --> Dezimal = 5 --> !S5<#10>

ACHTUNG: Bei RS485-Schnittstelle muß nach dem ! oder ? immer die jeweilige Adresse der Wetterstation eingefügt werden, da der Befehl sonst nicht abgearbeitet wird! (Standard@ = 1)

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y d.p65 Seite 24

### 8.2.2 Abfragen des Mikroprozessors

\*\*\* ABFRAGEN\*\*\*

Den aktuellen Datensatz abrufen:

'?' 'U' <#13>

Linearisierungsdaten, Sensorkonfiguration und Systeminfo abrufen:

"!" '?" <#13>

Linearisierungsdaten eines Sensors explizit abrufen:

"!" '?0' <#13>

Hier wird nur die Info über die Hauptkonfiguration ausgegeben.

"!" '?1" <#13>

Hier wird nur die Info über Konfiguration der einzelnen Sensoren ausgegeben.

"!" '?2" <#13>

Hier wird nur die Info für die Sensornummer 2 (Temperatur) ausgegeben.

...usw.

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y\_d.pmd Seite 25

### 8.2.3 Reihenfolge der Sensoren der MWS 3Y

Ausgabe-Nr.	Sensornr.	Kennung	Sensor Standardmäßig (MW)	S 3Y)	Einheit
1	0		Pseudo-Uhrzeit	aus	
2	1	$\operatorname{TD}$	Temperatur des Drucksensors	ein	[°C]
3	2	$\mathrm{TE}$	Temperatur	ein	[°C]
4	3	ZA	Zusatz1	aus	[mV]
5	4	DR	Druck	ein	[hPa]
6	5	RE	Regen (Wind Eingang)	aus	$[mm] / [l/m^2]$
7	6	GE	Zähler (Wind Eingang)	aus	[ ]
8	7	WG	Windgeschwindigkeit	ein	[km/h]
9	8	WR	Windrichtung	ein	[°]
10	9	ZB	Zusatz2	aus	[mV]
11	10	FE	Feuchte	ein	[%]
12	11	WS	Windspitze	ein	[km/h]
13	12	WD	Winddurchschnitt	ein	[km/h]
14	13	OH	eingegebene Ortshöhe	aus	
15	14	LX	Helligkeit	aus	[lux]

Achtung: Der Drucksensor benötigt den Sensor "Temperatur des Drucksensors" (TD) für die interne Temperaturkompensation zur korrekten Anzeige des Luftdrucks. Deshalb darf dieser nicht ausgeblendet werden! Bei Deaktivierung des Sensors TD wird ein falscher Luftdruck angezeigt!

Die Anzahl der Sensoren und die Kennung bei den 485Y-Sensoren ist abhängig von der Ausstattungsvariante.

### Weitere mögliche Kennungen:

- SO Globalstrahlung in [W/m<sup>2</sup>]
- SI Globalstrahlung in [W/m²] integriert (stark bedämpft und mit geringer Auflösung als SO
- UV UV-A Strahlung in [mW/m<sup>2</sup>]
- UI UV-Index (einheitslos)
- UD UV-Index (einheitslos) integriert (stark bedämpft und mit geringer Auflösung als SO
- WU Wolkenuntergrenze in [m]
- WK Bewölkung ja (1) / nein (0) (einheitslos)
- RD Niederschlag pro Speicherintervall in [mm] / [l/m²]

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y\_d.p65 Seite 26

### 9 Ersatzstecker

Bezugsquelle für eventuell benötigte Ersatzstecker: Fa. Yamaichi, Tel: 089 - 45109 146 Die Stecker sind Bestandteil der Serie Y-Circ P. Nachfolgend die Bestellnummer:

7poliger Stecker (Power & Data) Typnummer: **YCP-TPB09ACX-07MSCDX-051X** 7poliger Stecker (Power & Data) Bestellnummer: **80-05872** 

Sie können die Stecker natürlich auch von uns beziehen.

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y\_d.pmd Seite 27

### 9.1 Anschlussumsetzer Binder - Yamaichi


Wenn Sie eine MWS 3Y an ein altes bestehendes Kabel mit Binder Steckern anschließen wollen, benötigen Sie hierzu einen Anschlussumsetzer von Binder auf Yamaichi. Unten gezeigt ist der Umsetzer für die Power / Daten Buchse.

### **Anschlussumsetzer YAMAICHI-Binder 7-polig 1.0**

Standardt 10cm (Kabel auf 15cm (+/-2cm) ablängen,

### Kabel:

Kabeltronik LiYY Steuerleitung 4 x 0.14 mm² (AWG 26, A-Ø = ca. 4,1mm) Schwarz 095042609

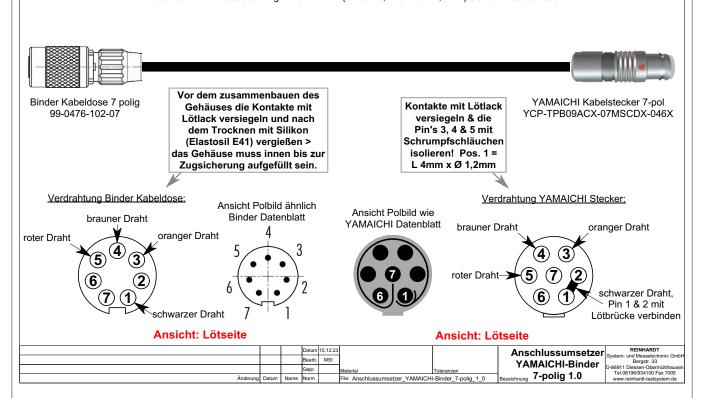

Irrtum / technische Änderungen vorbehalten 09/25

geändert am 25.09.2025 von DO

MWS3Y\_d.p65 Seite 28

REINHARDT System- und Messelectronic GmbH email: wetter@reinhardt-testsystem.de Web: www.reinhardt-wetterstationen.de